


Indicador Salida de Resultados del Laboratorio

No Cumple: 1.3 %

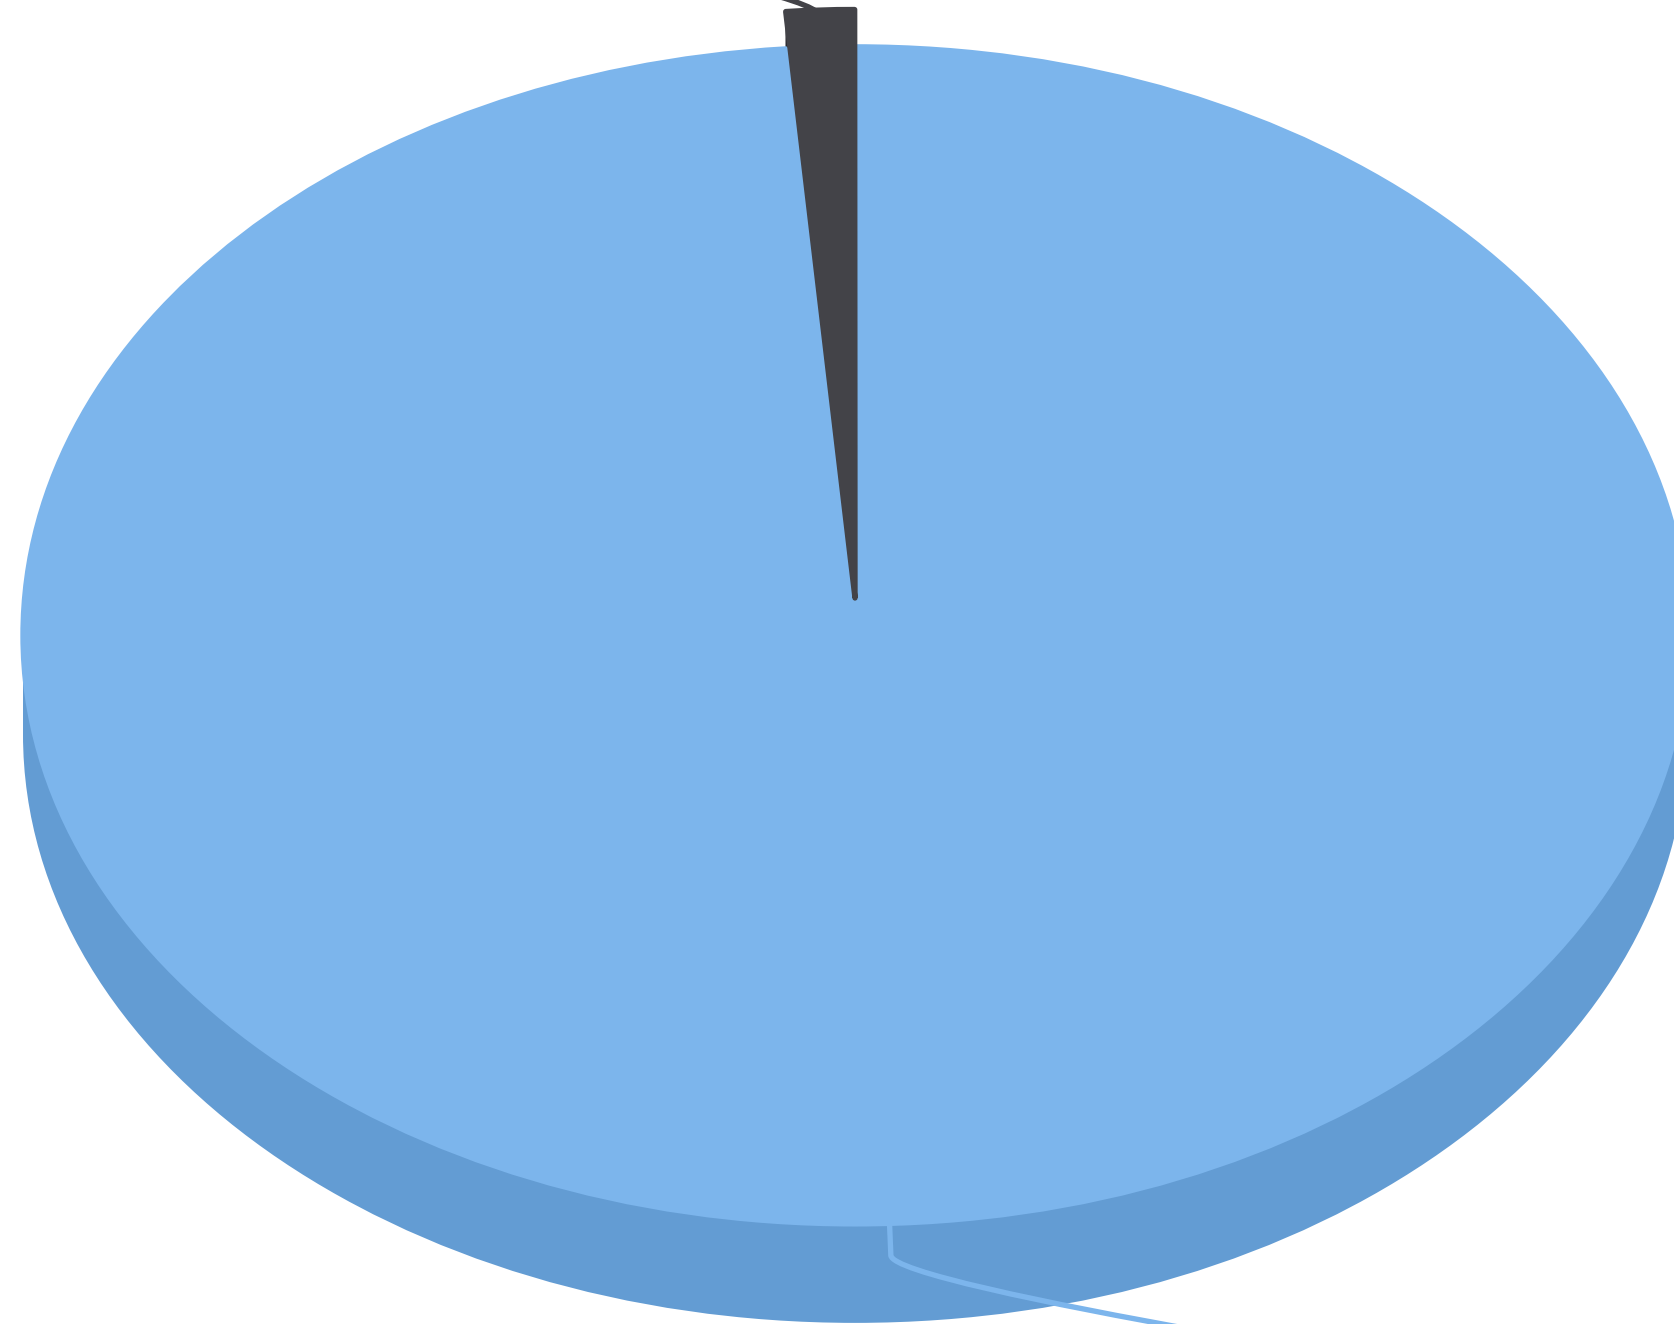

Si Cumple: 98.7 %